



LogBox-RHT-LCD

REGISTRADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE - MANUAL DE INSTRUÇÕES V2.0x

1 INTRODUÇÃO

O **LogBox-RHT-LCD** é um registrador eletrônico de temperatura e umidade relativa. Sensores medem estas grandezas e os valores (dados) obtidos são visualizados no display LCD e armazenados em memória eletrônica. Estes dados armazenados ou **AQUISIÇÕES** são posteriormente enviados a um computador para que sejam visualizados e analisados na forma de tabelas ou de gráficos. A saída de umidade pode ser configurada para representar o valor de **Umidade Relativa** medida ou o valor de temperatura do **Ponto de Orvalho**.

Os softwares configuradores **NXperience** e **LogChart II** são as ferramentas utilizadas para configurar o modo de funcionamento e para visualizar os dados coletados do registrador. Parâmetros como horários de início e de fim das aquisições e intervalos entre aquisições, por exemplo, podem ser facilmente definidos por meio tanto do software **NXperience** quanto do software **LogChart II**.

Os dados adquiridos pelo registrador podem ser exportados para análise em outros programas, tipo planilha eletrônica.

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Junto ao corpo do registrador está a etiqueta de identificação. Verifique se as características descritas nesta etiqueta estão de acordo com o que foi solicitado. O modelo **RHT-LCD** mede temperatura e umidade relativa.

No frontal do registrador estão os seguintes elementos:

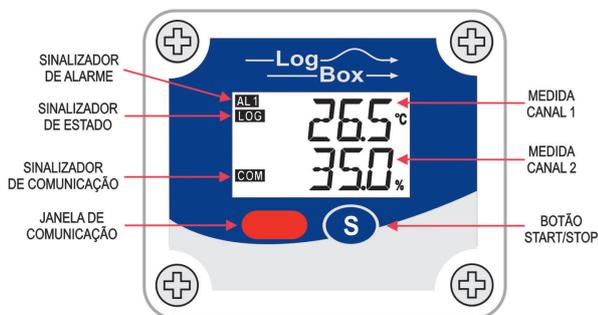


Fig. 1 – Frontal do Registrador

Botão START / STOP: Botão que pode ser configurado para iniciar ou parar as aquisições quando pressionado utilizado também para navegar ou mudar de tela.

Sinalizador de Estado (LOG): Este sinalizador ficará ativo quando o registrador estiver realizando aquisições.

Nota: Este sinalizador ficará desativado quando as aquisições forem finalizadas ou enquanto não forem iniciadas.

Sinalizador de Alarme (AL1 e/ou AL2): Este sinalizador informa as situações de alarme ocorridas e ficará ativo sempre que alguma situação de alarme ocorrer. Permanecerá nesta condição até que uma nova configuração seja aplicada ao registrador.

Sinalizador de Comunicação IR (COM): É ativado quando ocorre uma tentativa de comunicação ou quando a comunicação entre registrador e PC é estabelecida.

2 ESPECIFICAÇÕES

Temperatura de trabalho do registrador	De -40 °C a 70 °C
Faixa de medida do sensor	Temperatura: -40,0 °C a 80,0 °C. Umidade Relativa (RH): 0,0 a 100,0 %, sem condensação. Ponto de Orvalho: -40,0 °C e 100,0 °C
Precisão das medidas	Ver Fig. 2. Nota: O erro de medida encontrado pode ser eliminado no parâmetro OFFSET dos softwares NXperience e LogChart II .
Resolução das medidas	Temperatura: 0,1 °C. 14 bits (16383 níveis) Umidade Relativa (RH): 0,1 %. 12 bits (4095 níveis)
Tempo de resposta	Temperatura: Até 30 segundos com ar em movimento lento. Umidade: Até 8 segundos com ar em movimento suave (20 a 80%RH).
Capacidade da memória	32.000 (32 k) registros: Metade para cada canal ou total quando um dos canais estiver desabilitado.
Intervalo entre medidas	Mínimo de 1 segundo. Máximo de 18 horas
Alimentação	Bateria de lítio de 3,6 Vcc (1/2 AA), interna.
Autonomia estimada	Superior a 200 dias, com uma coleta semanal dos dados. A vida útil da bateria pode diminuir se os dados forem coletados frequentemente e o intervalo entre aquisição for muito baixo.
Caixa	Em Policarbonato
Grau de proteção	Produto adequado para aplicações que requeiram grau de proteção até IP40 .
Dimensões	60 x 70 x 35 mm
Tempo de transferência de dados registrador / PC	Proporcional ao número de registros. 40 segundos para 16.000 registros.
Interface com o PC	Interface Ir/USB ou Ir/Serial.
Ambiente de operação do software NXperience	Software configurador para Windows 10, 8, 7 e XP. Menus em Português, Inglês, Francês ou Espanhol. Configura, lê e apresenta os dados na tela.
Ambiente de operação do software LogChart II	Software configurador para Windows 7, Vista, XP, 2000, NT e 98. Menus em Português, Inglês ou Espanhol. Configura, lê e apresenta os dados na tela.

2.1 PRECISÃO DAS MEDIDAS

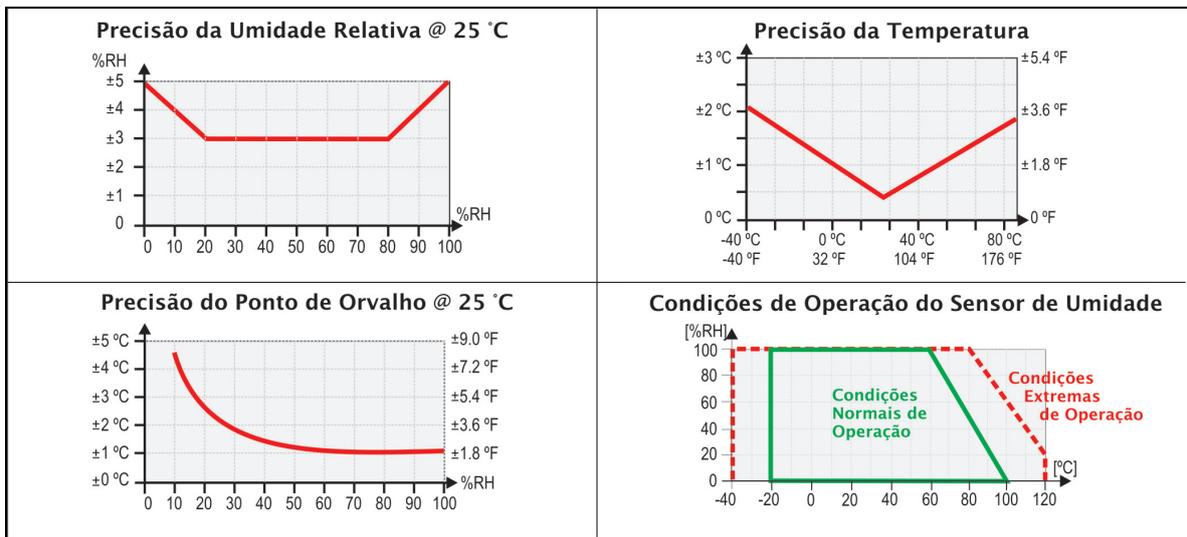


Fig. 2 - Precisão das medidas

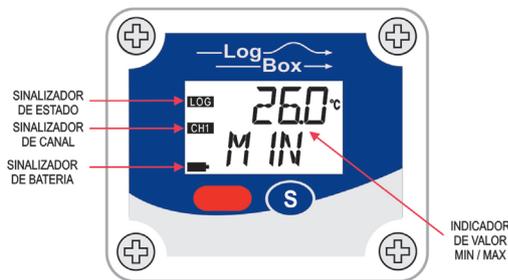


Fig. 3 - Frontal do registrador (CH1)

Sinalizador de Canal: Indica o canal selecionado.

Sinalizador de Bateria: O símbolo de bateria será mostrado quando a tensão da bateria estiver fraca.

Indicador de Valor MIN / MAX: Indica o valor mínimo e máximo de cada canal que ocorreu durante as aquisições.

3 OPERAÇÃO

Para operar o dispositivo, o usuário deve providenciar a instalação do software **NXperience** ou do software **LogChart II** em um computador, conforme instruções definidas nas seções [SOFTWARE NXPERIENCE](#) e [SOFTWARE LOGCHART II](#) deste manual.

A comunicação entre registrador e PC é realizada com o auxílio do dispositivo **Interface de Comunicação IR-Link**.


A configuração que define o modo de operação do registrador deve ser previamente elaborada nos softwares **NXperience** ou **LogChart II**. Esta configuração será passada para o registrador por meio do dispositivo **Interface de Comunicação IR-Link**.

O registrador inicia e finaliza as aquisições conforme a configuração realizada.

3.1 TELAS DO REGISTRADOR

MODO ECONOMIA DA BATERIA - **IdLE**


Modo de baixo consumo da bateria. O registrador não comunica. Sempre após o **reset** fica neste modo, o registrador não faz aquisições e não atualiza as medidas na tela. Para sair do modo **IdLE**, pressionar botão **S** para habilitar a comunicação temporariamente. Após o envio de uma configuração de aquisição, ficará definitivamente fora do modo **IdLE**.



Modo economia da bateria

TELA PRINCIPAL

Tela de indicação dos valores medidos no registrador:



1ª Tela - Temperatura e umidade



2ª Tela - Temperatura e ponto de orvalho

TELA INDICADOR MIN / MAX - CH1

Indica o valor mínimo e máximo do **Canal 1** que ocorreu durante as aquisições.



3ª Tela - Valor mínimo CH1



4ª Tela - Valor máximo CH1

TELA INDICADOR MIN / MAX - CH2

Indica o valor mínimo e máximo do **Canal 2** que ocorreu durante as aquisições.



5ª Tela - Valor mínimo CH2



6ª Tela - Valor máximo CH2

TELA COMUNICAÇÃO IR - COM

Configura comunicação IR para automático ou manual:

- No modo **automático (AUT)**, a comunicação estará sempre habilitada. Para comunicar, basta direcionar a interface e utilizar os softwares **NXperience** ou **LogChart II**. Sempre após o **reset** fica neste modo.
- No modo **manual (MAN)** a comunicação será habilitada por 20 segundos, após pressionar o botão **S**. Durante esse tempo, deverá ser iniciada uma comunicação para manter habilitada a Comunicação IR.




7ª Tela - Telas Comunicação IR

TELA INTERVALO DE ATUALIZAÇÃO DO DISPLAY - *d*.*5P*

Configura o tempo de leitura do sensor para a atualização do display. Quando selecionado por **Lo6**, realiza a leitura do sensor e atualização do display, conforme o intervalo configurado para a aquisição.

Quando selecionado por **10 S**, **30 S** ou **60 S** realiza a leitura do sensor para a atualização do display a cada 10, 30 ou 60 segundos. Neste modo se o intervalo de aquisição for menor que o tempo configurado na tela *d*.*5P*, o display será atualizado conforme o intervalo da aquisição.

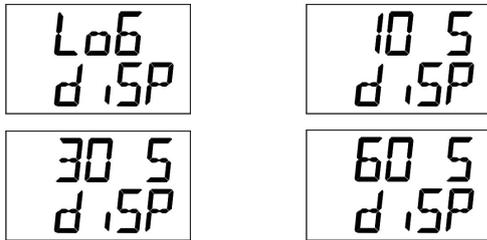

8ª Tela – Telas Intervalo de Atualização

4 AUTONOMIA DA BATERIA

A estimativa da autonomia da bateria é superior a 200 dias. Esta autonomia está relacionada diretamente com o modo de utilização do registrador. Quanto menor o intervalo de leitura do sensor, menor será a autonomia, podendo no pior caso, durar apenas 30 dias.

Para poupar a energia da bateria deve-se colocar o maior intervalo possível entre aquisições e da mesma forma a atualização do display.

Exemplos:

Ex. 1: Intervalo das aquisições igual a 10 minutos a tela do *d*.*5P* em modo **Lo6**. Neste caso o registrador permanece dormindo e somente acorda a cada 10 minutos para ler o sensor, atualizar o display e fazer as aquisições.

Ex. 2: Intervalo de aquisições igual a 10 minutos a tela *d*.*5P* em modo **60 S** (60 segundos). Neste caso, o registrador permanece dormindo e acorda a cada 1 minuto para fazer a medida do sensor e atualizar o display. A cada 10 minutos, acorda e realiza a medida do sensor para fazer as aquisições.

Comparando o Ex. 1 e o Ex. 2 com o mesmo intervalo de aquisições, o segundo exemplo consome 10 vezes mais bateria em relação ao primeiro, devido a constante leitura do sensor para a atualização do display.

Ex. 3: Modo médio, mínimo e máximo.

Quando for utilizado um destes modos de aquisição, são realizadas 10 leituras do sensor para fazer uma aquisição. Se o intervalo de aquisição for igual a 10 minutos e a tela *d*.*5P* em modo **Lo6**, será feita uma medida a cada 1 minuto para fazer as 10 medidas necessárias para a aquisição. Neste caso o consumo será o mesmo do **Ex. 2**.

Ex. 4: Início e final das aquisições.

Deve-se observar o melhor modo de início e fim das aquisições para economizar a bateria em função da necessidade das medidas.

Se o processo no qual são realizadas as medições, ocorre somente em um curto intervalo. O melhor é utilizar início e fim das aquisições pelo botão **S**.

Se o processo ocorre diariamente somente durante o horário diurno, o melhor modo é utilizar início e fim por data e repetição diária.

5 INSTALAÇÃO DA INTERFACE

No modelo **IR-Link3 / RS232**, existe uma interface de comunicação tipo RS232 / Ir, que deve ser conectada à porta serial disponível no PC.

No modelo **IR-Link3 / USB** existe uma interface de comunicação tipo USB / Ir, que deve ser conectada à porta USB disponível. Com este tipo de Interface, o Windows solicitará a instalação de *driver* apropriado. Este *driver* pode ser encontrado em nosso website.

5.1 INSTALAÇÃO DOS DRIVERS USB

As etapas de instalação de *drives* apresentadas podem variar de PC para PC, mesmo para uma mesma versão do sistema operacional. As etapas e telas apresentadas a seguir são apenas orientativas.

1. Execute o arquivo do *driver* disponível em nosso website.
2. Conecte a Interface de comunicação serial IrLink-3 à porta USB do PC. O Windows® irá reconhecer a presença do novo hardware e após alguns instantes irá iniciar o processo de instalação dos drivers.
3. O assistente de instalação de um novo hardware será apresentado, perguntando se o driver deve ser instalado a partir do site Windows Update. Selecione a opção “Não, não agora” e selecione Avançar (Fig. 4).
4. Selecione a opção “Instalar de uma lista ou local específico (avançado)” e clique em “Avançar” (Fig. 5).
5. Selecione a opção “Procurar o melhor driver nestes locais” e marque a opção “Pesquisar mídia removível”. Clique em “Avançar”. Caso os arquivos de instalação não estejam em um CD, marque a opção “Incluir este local na pesquisa” e indique o caminho para os arquivos (Fig. 6).
6. Se for apresentada uma tela informando sobre a não compatibilidade com o Windows® XP, clique em “Continuar assim mesmo”.
7. Os arquivos do driver da Interface serão copiados para o computador e após alguns instantes será apresentada uma tela informando que o assistente terminou a instalação do software para o conversor. Clique em “Concluir” (Fig. 7).
8. Em algumas situações, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez. Siga os mesmos procedimentos.

Em utilizações posteriores da interface, é possível que o Windows® solicite novamente a instalação do driver. Neste caso, o mesmo assistente de instalação será apresentado, bastando selecionar a opção “Instalar o software automaticamente (recomendável)”, pois o driver já está presente no computador.

Nas figuras a seguir são apresentados exemplos das telas do assistente de instalação para Windows XP®. Para Windows 2000® a aparência destas telas é ligeiramente diferente, mas o conteúdo é essencialmente o mesmo.



Fig. 4 – Tela inicial de instalação dos drives USB



Fig. 5 – Segunda tela de instalação dos drives USB

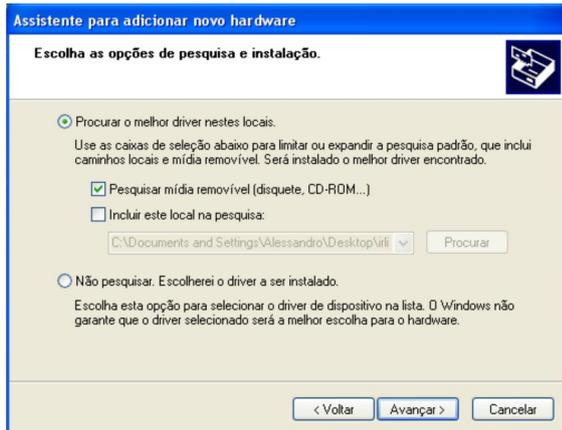


Fig. 6 – Terceira tela de instalação dos drives USB



Fig. 7 – Tela final de instalação dos drives USB

6 SOFTWARES CONFIGURADORES

É possível realizar a configuração do **LogBox-RHT-LCD** por meio dos softwares **NXperience** ou **LogChart II**. Para fazê-lo, entretanto, é necessário que a **Interface de Comunicação** esteja conectada ao computador.

A interface deve estar constantemente direcionada para o frontal do registrador (janela de comunicação) e a uma distância de até 50 cm, conforme mostra a **Fig. 8**.

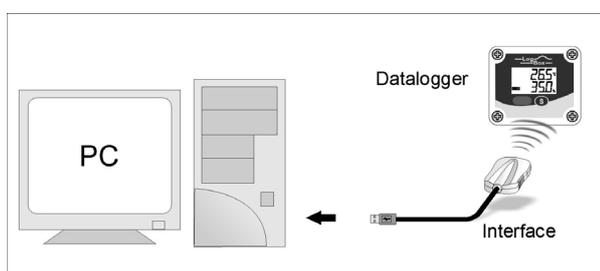


Fig. 8 – Interface de comunicação direcionada para o registrador

6.1 SOFTWARE NXPERIENCE

6.1.1 INSTALANDO O NXPERIENCE

O software **NXperience** permite explorar todas as funcionalidades e recursos do dispositivo, comunicando-se por meio de sua interface USB. É também uma ferramenta completa para realizar a análise dos dados registrados pelo **LogBox-RHT-LCD**.

Para instalar o **NXperience**, deve-se executar o arquivo **NXperienceSetup.exe**, disponível em nosso website www.novus.com.br/downloads/NX.

6.1.2 EXECUTANDO O NXPERIENCE

Ao abrir o software **NXperience**, a tela principal será mostrada:



Fig. 9 – Tela principal do software NXperience

6.1.3 CONFIGURANDO O NXPERIENCE

Para realizar a configuração do dispositivo, é necessário que ele esteja conectado à porta USB do computador. Ver **Fig. 8**.

Uma vez conectado, deve-se executar o **NXperience**, clicar em **Configurar** e, a seguir, clicar em **Leitura do Dispositivo**.

6.1.3.1 PARÂMETROS GERAIS

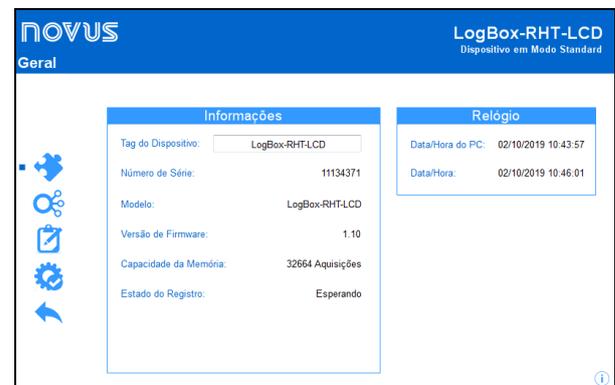


Fig. 10 – Parâmetros gerais

INFORMAÇÕES

- **Tag do Dispositivo:** Permite configurar um nome, que será utilizado como identificação do canal durante uma coleta, para o canal digital. O campo permite até 16 caracteres.
- **Número de Série:** Exibe o número único de identificação do dispositivo.
- **Modelo:** Exibe o modelo do dispositivo.
- **Versão de Firmware:** Exibe a versão do firmware gravada no dispositivo.
- **Capacidade da Memória:** Exibe o espaço em memória ainda disponível para novas aquisições.
- **Estado de Registro:** Informa se o dispositivo está registrando ou se está parado.

RELÓGIO

- **Data/Hora do PC:** Exibe a data e a hora do computador.
- **Data/Hora:** Exibe o data e a hora do dispositivo no momento em que foi lido pelo **NXperience**.

6.1.3.2 PARÂMETROS DOS CANAIS

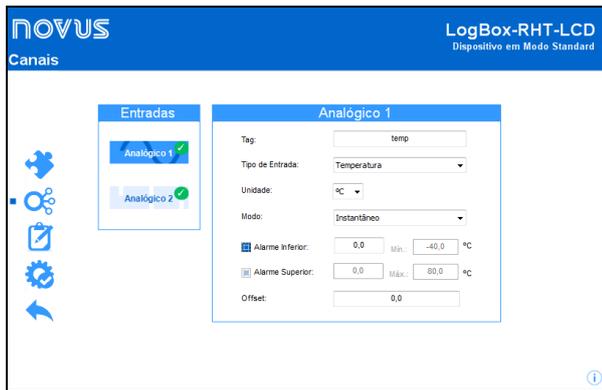


Fig. 11 – Parâmetros dos canais

- **Tag:** Permite configurar um nome, que será utilizado como identificação do canal durante uma coleta, para o canal. O campo permite até 16 caracteres.
- **Tipo de Entrada:** Exibe o tipo de entrada do canal: Temperatura para o Canal Analógico 1 e Umidade Relativa para o Canal Analógico 2.
- **Unidade:** Permite selecionar o modo de exibição da unidade do canal: Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) para o Canal Analógico 1 e porcentagem de umidade relativa (%) para o Canal Analógico 2.
- **Modo:** Permite configurar o modo de operação do canal.
 - **Instantâneo:** O valor registrado será o exato valor medido a cada intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 1 segundo.
 - **Mínimo:** O valor registrado será o mínimo valor encontrado em dez medidas consecutivas, feitas ao longo do intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundos.
 - **Máximo:** O valor registrado será o máximo valor encontrado em dez medidas consecutivas, feitas ao longo do intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundos.
 - **Médio:** O valor registrado será a média de dez medidas realizadas dentro do intervalo de aquisição. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundos.
- **Alarme Inferior:** Permite habilitar e configurar um *setpoint* de alarme inferior (opção disponível apenas se o Modo de Início dos registros for definido como "Início Imediato" ou "Data/Hora").
 - **Mínimo:** Exibe a temperatura mínima ou o nível mínimo de umidade relativa suportado pelo dispositivo.
- **Alarme Superior:** Permite habilitar e configurar um *setpoint* de alarme superior (opção disponível apenas se o Modo de Início dos registros for definido como "Início Imediato" ou "Data/Hora").
 - **Máximo:** Exibe a temperatura máxima ou o nível máximo de umidade relativa suportado pelo dispositivo.
- **Setpoint Inferior:** Quando a temperatura medida for menor que o valor definido neste parâmetro, o dispositivo iniciará os registros (opção disponível apenas se o Modo de Início dos registros for definido como "Setpoint").
 - **Mínimo:** Exibe a temperatura mínima ou o nível mínimo de umidade relativa suportado pelo dispositivo.
- **Setpoint Superior:** Quando a temperatura medida for maior que o valor definido neste parâmetro, o dispositivo iniciará os registros (opção disponível apenas se o Modo de Início dos registros for definido como "Setpoint").
 - **Máximo:** Exibe a temperatura máxima ou o nível máximo de umidade relativa suportado pelo dispositivo.
- **Offset:** Permite realizar pequenos ajustes nas leituras do canal. O *offset* configurado será somado em todas as leituras realizadas.

6.1.3.3 CONFIGURAÇÃO DE REGISTRO DE DADOS

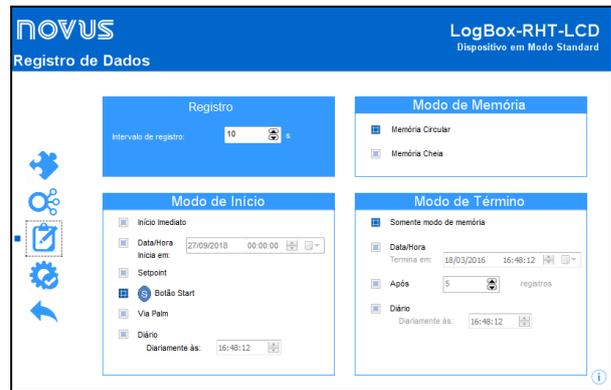


Fig. 12 – Registros de Dados

REGISTRO

- **Intervalo de registro:** Permite selecionar a periodicidade, em horas, minutos ou segundos, com que uma aquisição deve ser realizada e gravada na memória.

MODO DE MEMÓRIA

- **Memória Cheia:** As aquisições serão realizadas até que se atinja a capacidade da memória disponível.
- **Memória Circular:** As aquisições acontecem de forma contínua, sobrescrevendo registros mais antigos à medida que o número de aquisições ultrapassar a capacidade de memória.

MODO DE INÍCIO

- **Início Imediato:** O início é imediato. As aquisições iniciam assim que a configuração for concluída e enviada ao dispositivo.
- **Data/Hora:** O início acontece em dia e hora específicos.
- **Setpoint:** As aquisições iniciam quando um determinado valor for atingido. Nesta opção, o valor de *setpoint* é definido na aba **Canais**, nos parâmetros **Setpoint Superior** e **Setpoint Inferior** (estas opções aparecerão apenas quando este modo de registros for selecionado).
- **Botão Start** : As aquisições se iniciam e se interrompem com o pressionar do botão de Start/Stop, localizado no frontal do registrador, durante dois segundos.
- **Diário:** As aquisições se iniciam diariamente, na hora configurada.

MODO DE TÉRMINO

- **Somente Modo de Memória:** As aquisições serão realizadas até atingir a capacidade da memória disponível.
- **Data/Hora:** As aquisições se interrompem em data e hora definidas neste parâmetro. As aquisições serão interrompidas caso a capacidade de memória do registrador seja atingida antes da data definida.
- **Após (x) registros:** As aquisições se interrompem após o número configurado de registros.
- **Diário:** As aquisições se interrompem diariamente, na hora configurada.

6.1.3.4 FINALIZAÇÃO



Fig. 13 – Finalização

CONFIGURAÇÃO

- **Enviar Configurações:** Permite enviar a configuração para o dispositivo.
- **Salvar em Arquivo:** Permite salvar a configuração em um arquivo que poderá ser posteriormente utilizado.
- **Coletar Memória:** Permite coletar os dados da memória.

CONTROLE DE REGISTRO

- **Iniciar ou Continuar:** Permite iniciar ou retomar as aquisições que foram interrompidas pelo comando **Pausar**, sem descartar as aquisições que estão na memória do dispositivo, utilizando os parâmetros configurados.
- **Pausar:** Permite interromper as aquisições, possibilitando que, no futuro, sejam retomadas por meio do botão **Continuar**.
- **Parar:** Permite interromper definitivamente as aquisições, de forma que o dispositivo só volte a registrar quando receber uma nova configuração.

6.1.4 COLETANDO A VISUALIZANDO DADOS

A coleta de dados transfere para o computador os valores medidos pelo dispositivo. A coleta desses dados pode ocorrer a qualquer momento, ao fim do processo de aquisição ou durante um processo de aquisição.

Se a coleta de dados ocorrer durante o processo de aquisição, esse processo **não será interrompido**, seguindo conforme estabelece a configuração aplicada no dispositivo.

6.1.4.1 COLETANDO DADOS

A coleta dos dados adquiridos é efetuada por meio do botão **Coletar Registros** da guia **Coletar** do **NXperience**.

Durante o processo de coleta de dados, uma barra de progresso é mostrada, indicando o quanto já foi transferido. O tempo de transferência de dados será proporcional ao número de aquisições efetuadas.

6.1.4.2 VISUALIZANDO OS DADOS COLETADOS

Ao fim da transferência das aquisições, os dados serão apresentados em forma de gráfico.

GRÁFICO

É possível selecionar uma região do gráfico para ser visualizada em detalhes (**zoom**). Os comandos de **zoom** podem ser acessados por meio dos ícones relativos ao **zoom** na barra de ferramentas.

Pode-se também selecionar a área do gráfico a ser ampliada ao clicar e arrastar do mouse, criando-se uma região de **zoom** a partir do canto superior esquerdo da área de gráfico desejada.

As curvas do gráfico podem ser arrastadas verticalmente ao clicar com o botão direito e mover o mouse para cima ou para baixo, mantendo botão pressionado.



Fig. 14 – Tela de visualização gráfica dos dados coletados pelo **NXperience**

TABELA DE AQUISIÇÕES

O gráfico também apresenta os valores adquiridos em formato de tabela, relacionando o momento da medida com o seu valor.

Tabela de Aquisições				
N°	Data	Horário	temp (°C)	umid (%)
1	06/09/2019	11:28:20	22,6	57,2
2	06/09/2019	11:28:30	22,6	57,2
3	06/09/2019	11:28:40	22,6	57,1
4	06/09/2019	11:28:50	22,6	57,1
5	06/09/2019	11:29:00	22,6	57,1
6	06/09/2019	11:29:10	22,6	57,1
7	06/09/2019	11:29:20	22,6	57,1
8	06/09/2019	11:29:30	22,6	57,1
9	06/09/2019	11:29:40	22,6	57,1
10	06/09/2019	11:29:50	22,6	57,2

Fig. 15 – Tabela de aquisições do **NXperience**

INFORMAÇÕES GERAIS

Ademais da configuração realizada, essa janela mostra informações gerais sobre o dispositivo cujos dados foram recentemente lidos.

Tabela de Aquisições		Informações Gerais	
Registrador			
Modelo	LogBox-RHT-LCD		
Número de Série	11134371		
Versão de Firmware	1.10		
Capacidade de Memória	32768 Registros		
temp (°C)			
Entrada	NTC 10K		
Modo	Instantâneo		
Offset	0,0		
Alarme Inferior	N/D		
Alarme Superior	N/D		
umid (%)			
Entrada	NTC 10K		
Modo	Instantâneo		
Offset	0,0		
Alarme Inferior	N/D		
Alarme Superior	N/D		
Informações da Coleta			
Título	LogBox-SupTech		
Intervalo entre Aquisições	10 s		
Total de Aquisições	10		
Modo de Início das Aquisições	Nenhum		
Modo de Memória	Nenhum		
Modo de Final das Aquisições	Nenhum		
Momento da Coleta	01/10/2019 15:12:45		
Primeira Aquisição	06/09/2019 11:28:20		

Fig. 16 – Informações gerais do NXperience

6.1.4.3 OUTRAS FUNCIONALIDADES

Verifique o manual de operações do **NXperience** para obter mais informações sobre as demais funcionalidades oferecidas pelo software, como exportação a outros formatos, filtro de dados, junção de gráficos, etc.

6.2 SOFTWARE LOGCHART II

6.2.1 INSTALANDO O LOGCHART II

O software configurador **LogChart II** é utilizado para a configuração e para a coleta dos dados adquiridos do dispositivo. Para instalar o **LogChart II**, basta executar o arquivo **LC_II_Setup.exe**.

Importante: Certifique-se que a data em seu Windows esteja com o separador configurado como barra. Por exemplo: dd/mm/aa ou dd/mm/aaaa.

6.2.2 EXECUTANDO O LOGCHART II

Ao abrir o software **LogChart II**, a tela principal será mostrada:

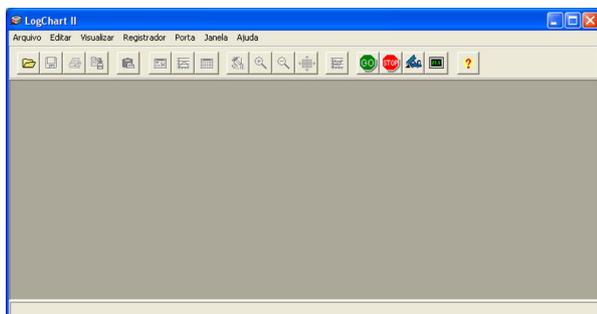


Fig. 17 – Tela Principal do software LogChart II

A seguir indicar a porta serial a ser utilizada pela interface de comunicação através do menu "Porta".

- Para modelo **IR-Link3 / RS232**:

Verifique em seu computador qual a porta serial livre. A porta selecionada será adotada como a porta padrão nas próximas vezes em que o programa for executado.

- Para modelo **IR-Link3 / USB**:

Selecionar a porta USB serial onde está a interface conectada.



Fig. 18 – Ícones habilitados quando há uma porta de comunicação válida

6.2.3 CONFIGURANDO O REGISTRADOR

Para configurar o registrador, é necessário que a **Interface de Comunicação** esteja conectada ao computador, na porta selecionada no item anterior.

Como explicado anteriormente, a **Interface de Comunicação** deverá estar direcionada para o frontal do registrador (janela de comunicação), como mostra a **Fig. 08** (ver início do capítulo [SOFTWARES CONFIGURADORES](#)).

Uma vez que a comunicação entre o registrador e o **LogChart II**

tenha sido estabelecida, selecione:



A tela **Parâmetros de Configuração** é apresentada. Nesta tela o **LogChart II** permite ao usuário definir o modo de operação do registrador e também obter informações gerais sobre o aparelho.

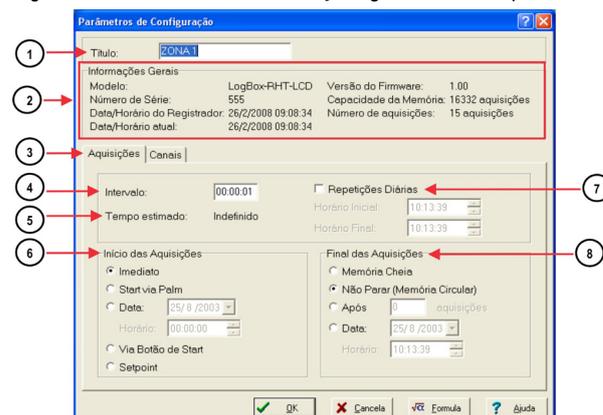


Fig. 19 – Configuração do Registrador (Aquisições)

Os campos são:

① **Título:** Neste campo o usuário identifica o registrador dando-lhe um nome.

② **Informações Gerais:** Campo informativo. São apresentadas informações referentes ao registrador, tais como; Modelo, Número de série, Data/Horário do registrador, Data/Horário atual do computador, versão do *firmware* (versão do modelo do registrador), capacidade de memória e número de aquisições em memória.

Neste campo os horários são constantemente atualizados enquanto a comunicação entre registrador e computador estiver estabelecida.

③ **Aquisições:** Apresenta uma série de parâmetros que definem como se dará as aquisições:

④ **Intervalo:** define o intervalo de tempo entre as aquisições. O intervalo mínimo é de 1 (um) segundo.

Nota: Quando o tipo de valor a ser registrado for média, máximos ou mínimos, o intervalo mínimo passa para 10 segundos.

Com a seleção de **Repetições Diárias**, o usuário define um horário em que, diariamente, o registrador realizará as aquisições.

- 5 **Tempo Estimado:** Neste parâmetro, o registrador informa ao usuário quanto tempo levará para ocupar totalmente a memória, nas condições definidas na configuração elaborada.
- 6 **Início das aquisições:** As aquisições podem iniciar de quatro modos diferentes:
 - **Imediato:** início imediato, assim que a programação é dada por encerrada e enviada (OK) ao registrador.
 - **Data:** o início acontece em dia e hora específicos.
 - **Via Botão de Start:** inicia e interrompe as aquisições com o pressionar por dois segundos do botão de Start, localizado no frontal do registrador.
 - **Setpoint:** as medidas iniciam quando um determinado valor de **temperatura** é atingido. Nesta opção, o valor de setpoint é definido no campo Canais, onde o parâmetro Alarme é substituído por setpoint.
- 7 **Repetições Diárias:** Com a seleção de *Repetições Diárias*, o usuário define um horário em que, diariamente, o registrador realizará as aquisições.
- 8 **Final das aquisições:** As opções para o término das aquisições são:
 - **Memória Cheia:** as aquisições são realizadas até atingir a capacidade da memória disponível.
 - **Não Para (Memória Circular):** as aquisições acontecem de forma contínua, sobrescrevendo registros mais antigos à medida que o número de aquisições ultrapassa a capacidade de memória.
 - **Após:** o registrador interrompe as aquisições após um determinado número de registros.
 - **Data:** As aquisições terminam em data e hora pré-definidas pelo usuário. Caso a capacidade de memória do registrador seja atingida antes da data definida as aquisições são interrompidas.
- 9 **Canais:** Apresenta parâmetros relativos aos canais individualmente. Canal 1 refere-se à temperatura e Canal 2 à Umidade relativa.

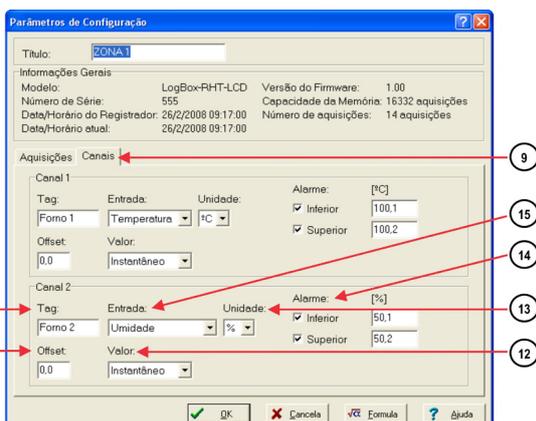


Fig. 20 – Configuração do Registrador (Canais)

- 10 **Tag:** Define um nome para os registros de temperatura.
- 11 **Offset:** Permite fazer correções ao valor registrado.
- 12 **Valor:** Define como o valor medido será registrado. As opções são:
 - **Instantâneo:** O valor registrado será o exato valor medido a cada intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 1 segundo.
 - **Médio:** O valor registrado será a média aritmética de dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundos.

- **Máximo:** O valor registrado será o máximo valor encontrado em dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundo.
 - **Mínimo:** O valor registrado será o mínimo valor encontrado em dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundo.
 - 13 **Unidade:** Define a unidade de medida da grandeza monitorada: °C ou °F para o canal 1 (temperatura) e apenas % para o canal 2 (umidade relativa ou ponto de orvalho).
 - 14 **Alarme:** Define valores limites que, quando ultrapassados, caracterizam uma situação de alarme. As situações de alarme são informadas ao usuário através do **Sinalizador de Alarme**. O valor limite de alarme é mostrado com uma linha pontilhada da mesma cor do canal no gráfico do software **LogChart II**.
 - 15 **Entrada:** Parâmetro disponível no canal 1 (**temperatura**) e no canal 2 (**umidade** ou **ponto de orvalho**). Nele pode desligar o canal 1 também, e reservar toda a memória para umidade. Pode selecionar aquisição do Ponto de Orvalho.
- Após o preenchimento dos campos selecionar "OK", e a configuração é, então, enviada para o registrador.

6.2.4 COLETANDO E VISUALIZANDO DADOS

Os dados adquiridos pelo registrador podem ser transferidos para um PC utilizando o software **LogChart II**, que os apresenta em forma gráfica e tabela. Os dados podem ser salvos em arquivos para futuras análises e comparações.



6.2.4.1 COLETANDO DADOS

A coleta dos dados adquiridos é efetuada clicando no ícone **Coletar Aquisições**, e direcionando a interface para o frontal do registrador. Durante o processo de transferência de dados, uma barra de progresso é mostrada, indicando o quanto falta para ser transferido. O tempo de transferência de dados é proporcional ao número de aquisições efetuadas.

6.2.4.2 VISUALIZANDO OS DADOS COLETADOS

Após a transferência das aquisições, os dados são apresentados em forma de gráfico.

JANELA DO GRÁFICO



É possível selecionar uma região do gráfico para ser visualizada em detalhe (**zoom**). Os comandos de **zoom** podem ser acessados através do menu *Visualizar* ou através dos ícones relativos ao **zoom** na barra de ferramentas.

Pode-se, também, selecionar a área do gráfico a ser ampliada através do clique e arraste do mouse, criando-se uma região de **zoom** a partir do canto superior esquerdo da área de gráfico desejada.

Na janela do gráfico são mostrados os valores mínimos e máximos de cada canal. Mostra também a linha horizontal dos valores de alarme configurados.

Pode ser associado um texto aos pontos do gráfico, basta dar um duplo clique em um ponto da curva.

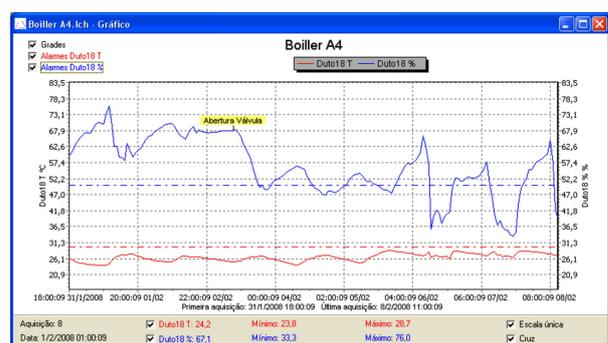


Fig. 21 - Tela de visualização gráfica dos dados coletados

A coleta de aquisições **não** interrompe o processo de medida e registro dos dados.

JANELA DA TABELA DE AQUISIÇÕES



A apresentação em forma de tabela pode ser obtida pressionando o ícone **Visualização em Tabela**. Este modo apresenta os valores adquiridos em formato de tabela, relacionando o horário da medida com o seu valor (Fig. 22).

Nº Aquisição	Horário	Data	Duto18 T [°C]	Duto18 % [%]
00001	18:00:09	31/1/2008	26,1	59,7
00002	19:00:09	31/1/2008	25,7	60,8
00003	20:00:09	31/1/2008	25,2	62,6
00004	21:00:09	31/1/2008	24,9	64,2
00005	22:00:09	31/1/2008	24,7	65,4

Fig. 22 – Tabela de Aquisições

JANELA DAS INFORMAÇÕES GERAIS



Essa janela mostra algumas informações sobre registrador cujos dados foram recém lidos e sua configuração. Esta tela pode ser apresentada através do ícone **Visualização de Parâmetros**.

Na janela de *Informações Gerais* (Fig. 23), pode se adicionado um texto com observações a respeito dos dados coletados.

Informações Gerais	
Registrador	
Modelo:	LogBox RHT LCD
Número de Série:	13245678
Versão do Firmware:	1.00
Capacidade da Memória:	16332 aquisições
Canal 1 [°C]	
Entrada:	Temperatura
Valor:	Aquisições por valor instantâneo
Offset:	0,0
Alarme Inferior:	Indefinido
Alarme Superior:	Indefinido
Canal 2 [%]	
Entrada:	Umidade
Valor:	Aquisições por valor instantâneo
Offset:	0,0
Alarme Inferior:	Indefinido
Alarme Superior:	Indefinido
Informações da Coleta	
Título:	LogBox
Intervalo entre aquisições:	1 s
Número total de aquisições:	16332
Início das Aquisições:	Data: 7/1/2008 Horário: 11:20:21
Final das Aquisições:	Após 10 aquisições
Momento da coleta:	quarta-feira, 16 de janeiro de 2008 às 13:16:40
Primeira aquisição:	sexta-feira, 14 de dezembro de 2007 às 17:21:48
Última aquisição:	sexta-feira, 14 de dezembro de 2007 às 21:53:59
Digite aqui um comentário para identificação dos dados coletados.	

Fig. 23 – Informações Gerais

7 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

7.1 NÃO É POSSÍVEL EFETUAR A COMUNICAÇÃO COM O REGISTRADOR

Verificar se a porta de comunicação está corretamente selecionada e se não há nenhum outro *software* utilizando esta porta durante as tentativas de comunicação.

Verificar se não há qualquer obstáculo impedindo a passagem do sinal infra-vermelho.

Verificar se o cabo está bem conectado na porta do computador.

Assegurar-se que a porta selecionada está funcionando bem.

7.2 RESET DO REGISTRADOR

Quando o usuário está em dúvida sobre a real condição de funcionamento do registrador pode provocar um *Reset*, para isto, basta retirar a pilha e aguardar 2 minutos e após recolocar a pilha no lugar. Quando resetado, o registrador volta ao estado de *stand-by*. Se estiver realizando aquisições, interrompe o processo e somente inicia as aquisições no momento que for enviada uma

nova configuração. A configuração implementada permanece inalterada após o *reset*.

7.3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para o esclarecimento de qualquer dúvida a respeito deste e de outros aparelhos, acesse o site do fabricante.

8 CUIDADOS ESPECIAIS

O registrador, por se tratar de um aparelho eletrônico, necessita de alguns cuidados no manuseio:

- Ao abrir o aparelho para troca de bateria ou para fixação dos sensores, deve-se evitar o contato com o circuito eletrônico devido ao risco de danos causados pela eletricidade estática.
- Observar com máxima atenção a polaridade da bateria.
- Ao fechar a caixa, a tampa deve ser recolocada de modo adequado, garantindo o grau de vedação deste modelo.
- As baterias usadas não devem ser recarregadas, desmontadas ou incineradas. Após o uso, elas devem ser recolhidas segundo a legislação local ou enviadas de volta ao fornecedor.

Nota: O transmissor deve ser fixado com a cápsula do sensor voltada para baixo para garantir a precisão e grau de proteção especificados.

8.1 CUIDADOS COM OS SENSORES

A calibração do sensor de umidade pode ser alterada se este é exposto a vapores contaminantes ou a condições extremas de umidade e temperatura por períodos prolongados. Para acelerar o restabelecimento da calibração, proceda conforme descrito a seguir:

- Retire o sensor da cápsula.
- Caso haja deposição de partículas sólidas sobre o sensor, lave-o com água.
- Coloque o sensor em um forno a 80 °C (+ -10 °C) por 24 horas.
- Coloque o sensor por 48 horas em um local com temperatura entre 20 e 30 °C e umidade maior que 75 % RH.
- Recoloque o sensor na cápsula.

IMPORTANTE

O sensor utilizado neste equipamento pode ser danificado ou descalibrado se exposto a atmosferas contaminadas com agentes químicos. Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico e Amônia em concentrações elevadas podem danificar o sensor. Acetona, Etanol e Propileno Glicol podem causar erros de medida reversíveis.

9 GARANTIA

As condições de garantia se encontram em nosso website www.novus.com.br/garantia.